

【医師・看護師向け】

レクビオ[®]投与方法

NOVARTIS


NOVARTIS

レクビオ[®]投与方法

【医師・看護師向け】

プレフィルドシリンジの構造および名称

本剤を使用する前に、以下に記載された重要事項をご確認ください。

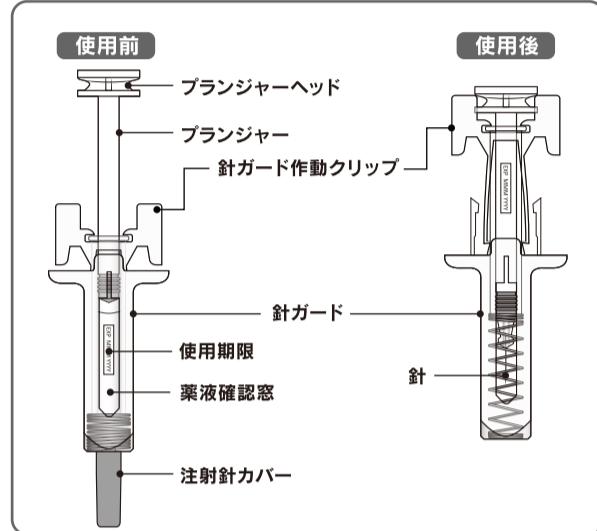

- 外箱やプラスチックトレイの封が破れている場合は、プレフィルドシリンジを使用しないでください。
- 注射の準備が整うまで注射針カバーを外さないでください。
- プレフィルドシリンジを硬い所に落とした場合や、注射針カバーを外した後に落とした場合は、使用しないでください。
- プレフィルドシリンジの再使用や分解はしないでください。
- プレフィルドシリンジには、注入完了後に注射針を覆う針ガードがついています。この針ガードにより、注射後の針刺し事故を防ぎます。

投与方法

プレフィルドシリンジを点検する


薬液中に気泡が見える場合がありますが、問題はありません。気泡を除去しようとしてください。

- プレフィルドシリンジが壊れていったり、薬液がプレフィルドシリンジから漏れたりしている場合は、使用しないでください。
- プレフィルドシリンジのラベルおよび外箱に表示されている使用期限を過ぎている場合は、使用しないでください。

2. 注射針カバーを外す


注射針カバーをしっかりと持つまゝに引っ張り、プレフィルドシリンジから外します。注射針の先に薬液の水滴が見えることがあります、問題ありません。

注射針カバーは再使用せず、廃棄してください。

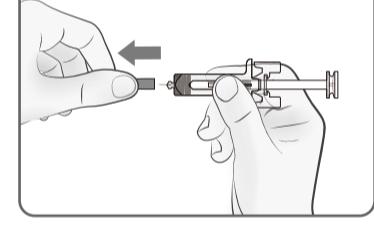


3. 注射針を刺す

注射部位の皮膚を軽くつまみ、その状態を保ったまま、もう一方の手で注射針を約45度の角度で皮膚に刺しこんでください。

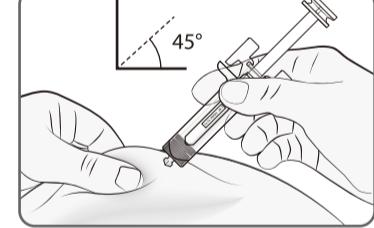


4. 注入を開始する

注射部位の皮膚をつまんだまま、ゆっくりとブランジャー・ヘッドを押しきり、全量を注入します。

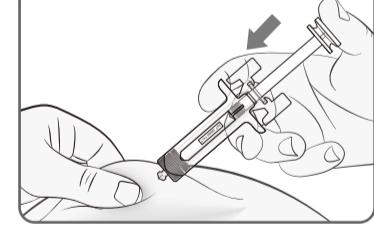


5. 注入を完了する

ブランジャー・ヘッドが針ガード作動クリップの間に完全におさまったことを確認します。これにより針ガードが作動し、注入完了後に針を覆います。

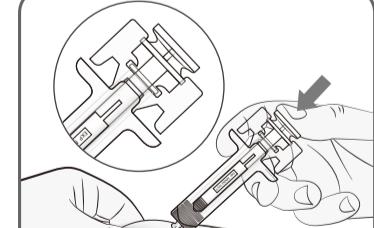

6. ブランジャーを離す

プレフィルドシリンジを注射部位に維持したまま、針ガードが注射針を覆うまでブランジャーをゆっくり離します。注射部位からプレフィルドシリンジを抜きます。

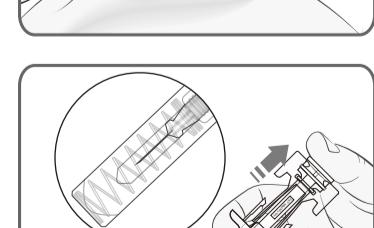

7. シリンジを廃棄する

使用済みのシリンジは自治体の規制に従って廃棄してください。